


شماره مدرک: ۱۱۱/۲۰۸/ر شماره تجدید نظر: ۱	سازمان ملی استاندارد ایران اداره کل استاندارد استان زنجان فلوجارت روش اجرایی تمدید گواهینامه آزمایشگاه های همکار	صفحه ۲ از ۲ تاریخ تجدید نظر: ۹۴/۰۶/۲۳
---	--	--

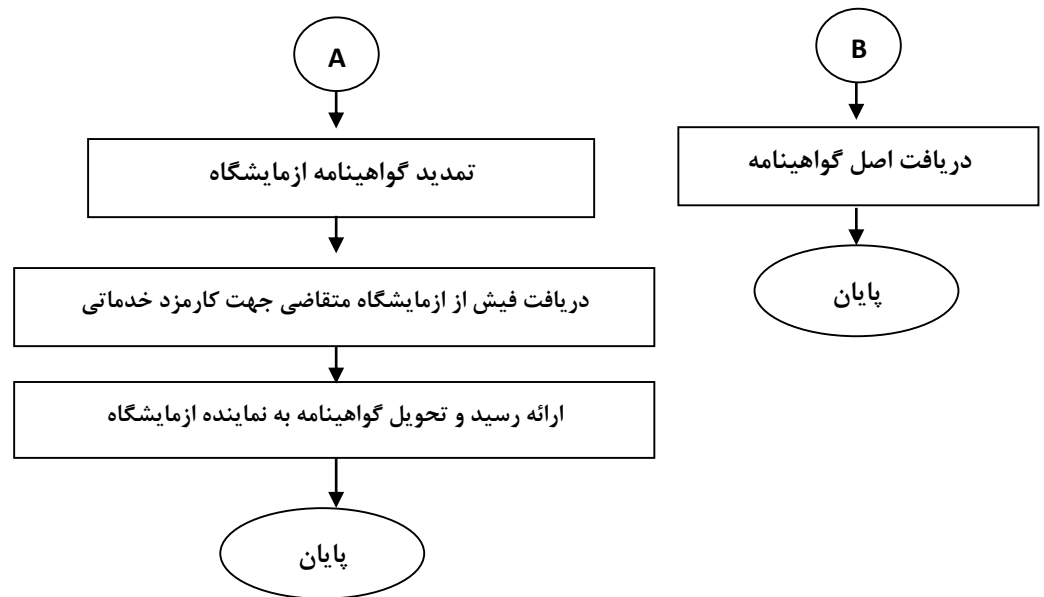

فرایند تمدید گواهینامه آزمایشگاه بسته به وجود عدم انطباق و مهلت رفع آن حداکثر در بازه ۲ ماه قبل از تاریخ انقضا گواهینامه آغاز و بسته به کامل بودن شرایط آزمایشگاه و سوابق و مستندات تا تاریخ انقضا گواهینامه می تواند به طول بیانجامد و در صورت عدم رفع مشکلات ابطال خواهد شد.